

# PRASĪBAS TIRDZniecībā LIETOJAMIEM SVARIEM

## NEAUTOMĀTISKIE SVARI

Neautomātiskajiem svariem, kurus izmanto tirdzniecības operācijās ir jānodrošina precizitāte visā to lietošanas laikā.

## PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS


- Likums Par mērījumu vienotību;
- Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumi Nr. 210 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 210);
- Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu" (turpmāk Noteikumi Nr. 40):
  - Tirdzniecībā izmantotajiem svariem, atkarībā no precizitātes klases, ir noteikts verificēšanas periodiskums.

## ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS MARKĒJUMS



M - metroloģiskais papildmarķējums, kurā norādīti tā gada pēdējie divi cipari, kurā veikta atbilstības novērtēšana

## VERIFICĒŠANAS ATZĪMES



Inspicēšanas institūcijas identifikācijas numurs (LATAK)

**Inspicēšanas institūcija** - LATAK akreditēta svaru atkārtotās verificēšanas institūcija

**Paziņotā insitūcija** - Eiropas Komisijai paziņota svaru atbilstības novērtēšanas institūcija

**Inspicēšanas institūciju saraksts**, kuras tiesīgas veikt neautomātisko svaru atkārtoto verificēšanu atradīsiet [www.latak.gov.lv](http://www.latak.gov.lv) (sadaļā akreditētās institūcijas).

Inspicēšanas institūcijas var atteikt verificēšanu, ja svariem nav pieejami apliecinājumi (*marķējums uz svariem, piemēram, atbilstības novērtēšanas marķējums vai cits marķējums, ja tāds bija piemērojams*) par to atbilstību piemērojamām prasībām brīdī, kad svāri tika nodoti lietošanā.

### VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

[www.ptac.gov.lv](http://www.ptac.gov.lv)


[pasts@ptac.gov.lv](mailto:pasts@ptac.gov.lv)

konsultācijas komersantiem:  
68806540 un 68806552




Precizitātes klases (norādītas marķējumā)	Svaru lietošanas nozare	Atkārtotās verificēšanas periodiskums
I	Augstas precizitātes svēšanas operācijām (piemēram, laboratorijās vai juvelierizstrādājumos)	Ne retāk kā reizi 2 gados
II		
III	Vidējas precizitātes svēšanas operācijām (piemēram, tirdzniecībā vai ārstniecībā ķermeņa masas noteikšanai)	Ne retāk kā reizi gadā
III	Svēšanas operācijām, kur nav nepieciešama augsta vai vidēja svēšanas precizitāte (piemēram, graudu, akmeņogļu vai atkritumu svēšana)	

Svaru lietotājam ir pienākums **nodrošināt** pierādījumus par svaru atbilstības novērtēšanu pirms to nodošanas lietošanā, kā arī **attiecīgo marķējumu un zīmogojumu saglabāšanu**.



Svariem, kas ražoti pēc 2006. gada, ir jābūt pilnam atbilstības novērtēšanas marķējumam. Piemēram, tie nedrīkst būt daļēji nomazgāti vai noplēsti.

## SVARI LIETOŠANĀ

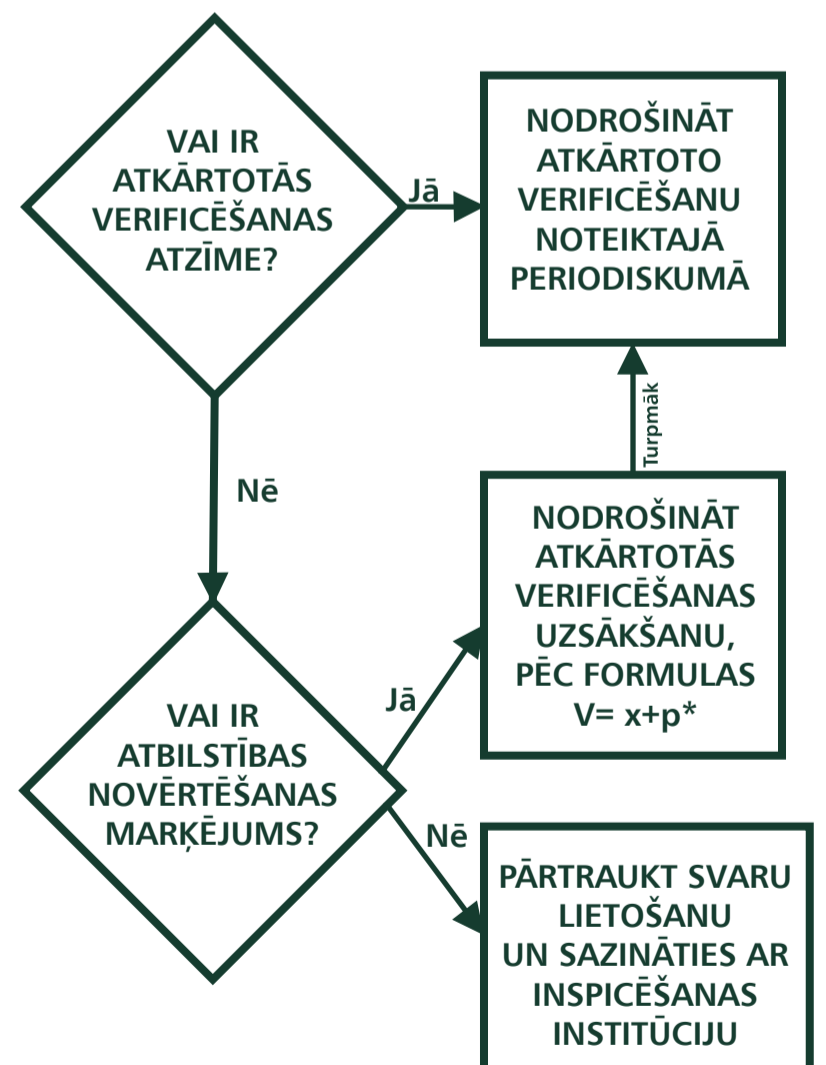

\* Verificēšanas uzsākšana jauniem svariem  
x - atbilstības novērtēšanas gads  
p - atkārtotās verificēšanas periodiskums  
v - Verificēšanas uzsākšanas laiks (gads līdz 31. decembrim)

$$V = x + p$$

piemēram, III, IV precizitātes klase

**CE M20 0122**

atkārtotā verificēšana jāveic līdz:

$V = 20 + 1 \rightarrow$  2021. gada 31. decembrim